

nox medical

NOX T3_s

MANUAL

Italiano

Manuale Nox T3s

Versione 2.3

Ultima revisione: 2025-04

Copyright © 2025

Nox Medical - Tutti i diritti riservati

Prodotto da:

Nox Medical ehf

Katrinartuni 2

IS - 105 Reykjavik

Isalanda

Sito web: www.noxmedical.com

nox medical

Per maggiori informazioni sul distributore, visitare: www.noxmedical.com

CE 2797

Informativa sul copyright

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, memorizzata su supporto elettronico, tradotta in qualsiasi lingua o linguaggio informatico, in qualsiasi forma o tramite qualsiasi mezzo: elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o di altro tipo, in mancanza di previo consenso scritto da parte di Nox Medical.

Avviso di licenza

Il firmware del registratore Nox T3s contiene un codice aritmetico a precisione multipla BIGDIGITS originariamente scritto da David Ireland, copyright © 2001-8 di D.I. Management Services Pty Limited <www.di-mgt.com.au>, ed è utilizzato con autorizzazione.

Indice

Indice	3
Elenco delle abbreviazioni	5
Introduzione	7
Destinazione d'uso.....	7
Controindicazioni.....	7
Ambito	7
Avvertenze e precauzioni d'uso	8
Istruzioni per gli operatori	10
Descrizione del Nox T3s.....	11
Interfaccia del Nox T3s.....	11
Utilizzo del Nox T3s	13
Collegamento del Nox T3s al computer.....	13
Configurazione e download dal Nox T3s	13
Avvio/arresto collegando le cinture RIP sul Nox T3s	13
Avvio/arresto premendo il pulsante sul Nox T3s (manuale)	14
Avvio del Nox T3s a un'ora prestabilita	14
Stato del Nox T3s	15
Collegamento del paziente al Nox T3s	18
Inserimento di una batteria nel Nox T3s	18
Collegamento del Nox T3s e delle cinture RIP Nox.....	19
Collegamento della cannula nasale Nox.....	21
Misurazione della pressione della maschera.....	22
Rilevamento dei segnali ExG.....	23
Misurazione del polso e della saturazione dell'ossigeno mediante il pulsossimetro Nonin 3150 BLE	23
Inserimento delle batterie nel pulsossimetro Nonin 3150 BLE	25
Scegliere la dimensione del sensore ossimetrico	25

Collegamento del pulsossimetro Nonin 3150 BLE e del sensore flessibile	25
Connessione tra il pulsossimetro Nonin 3150 BLE e il registratore Nox T3s	27
Manutenzione.....	32
Dispositivi e sensori compatibili	36
Specifiche.....	40
Nox T3s e accessori	40
Informazioni sui materiali	42
Informazioni normative	43
Test delle prestazioni e riepilogo della convalida	43
Classificazioni del Nox T3s	43
Descrizione dei simboli e delle etichette	44
Tecnologia wireless Bluetooth®	46
Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)	46
Informazioni	51

Elenco delle abbreviazioni

ABS	-	Acrilonitrile-butadiene-stirene
IMC	-	Indice di massa corporea
CISPR	-	<i>Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques</i> (comitato internazionale speciale per le interferenze radio)
CMDR	-	Canada Medical Device Regulations (normative canadesi sui dispositivi medici)
ECG	-	Elettrocardiografia
EEG	-	Elettroencefalografia
EMG	-	Elettromiografia
CEM	-	Compatibilità elettromagnetica
EOG	-	Elettrooculografia
ESD	-	Scariche elettrostatiche
HF	-	Alta frequenza
CEI	-	Commissione elettrotecnica internazionale
ISM	-	Industrial, Scientific and Medical (banda riservata alle applicazioni di radiocomunicazioni per uso industriale, scientifico e medico)
MDD	-	Direttiva sui dispositivi medici
RM	-	Risonanza magnetica
NiMH	-	Batteria ricaricabile nichel-metallo idruro
PAP	-	Pressione positiva alle vie aeree
PC	-	Policarbonato
PET	-	Polietilene tereftalato
PE	-	Polietilene
PID	-	Identificazione del prodotto
PVC	-	Cloruro di polivinile
RED	-	Radio Equipment Directive (direttiva europea sulle apparecchiature radio)
RF	-	Radiofrequenza
RIP	-	Pletismografia di induttanza respiratoria

SpO2	-	Livelli di saturazione dell'ossigeno misurati mediante pulsossimetria
TPE	-	Elastomero termoplastico
VID	-	Identificazione del fornitore
RAEE	-	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Introduzione

Congratulazioni per aver scelto il registratore Nox T3s™. Il Nox T3s è un registratore del sonno ambulatoriale da indossare direttamente sul corpo che fa parte del sistema Nox T3s. La sua funzione principale è quella di registrare i segnali fisiologici durante il sonno utilizzando sensori integrati e sensori applicati al paziente. Il registratore Nox T3s è dotato di un modulo Bluetooth® integrato che consente anche di registrare segnali provenienti da dispositivi ausiliari compatibili. Il posizionamento del registratore e il collegamento dei sensori sono semplici e rendono l'installazione agevole e veloce. Il registratore Nox T3s è configurato dal software Noxturnal di Nox Medical in esecuzione su un PC. Il software consente anche la revisione, l'organizzazione, l'analisi e il riepilogo di tutti i segnali registrati dal dispositivo. La complessità dello studio viene definita modulando il numero e i tipi di segnali fisiologici misurati.

Destinazione d'uso

Il registratore Nox T3s è indicato per la registrazione ambulatoriale dei segnali fisiologici durante il sonno. I segnali registrati vengono scaricati su un PC dove è possibile visualizzarli e analizzarli grazie all'applicazione Nox T3s (Noxturnal). Il registratore Nox T3s è indicato per l'uso con pazienti di età superiore ai 2 anni.

Le aree di destinazione d'uso sono ospedali, istituzioni, centri del sonno, cliniche del sonno o altri centri di monitoraggio, inclusa l'abitazione del paziente.

Controindicazioni

Il registratore T3s **NON** è indicato per il monitoraggio o la diagnosi automatica del paziente.

Ambito

Il presente manuale verte sull'uso del registratore Nox T3s e dei suoi componenti, come pure dei sensori esterni e dei dispositivi ausiliari omologati per il sistema Nox T3s. Il registratore Nox T3s è una nuova variante del registratore Nox T3.

L'uso del registratore Nox T3 e dei suoi componenti con i sensori esterni e i dispositivi ausiliari omologati per il sistema Nox T3 è illustrato in:

- Manuale Nox T3

L'immagine seguente mostra le differenze visive tra il registratore Nox T3 e il registratore Nox T3s. Prestare attenzione ad utilizzare il manuale corretto per il proprio registratore.



Registratore Nox T3



Registratore Nox T3s

L'uso dell'applicazione Noxturnal necessaria per la configurazione del dispositivo, e il trasferimento, la revisione e l'analisi dei dati è illustrato in:

- Manuale Noxturnal

Il presente manuale è destinato esclusivamente a professionisti (operatori sanitari e tecnici dell'assistenza) dotati delle necessarie competenze e qualifiche. Le istruzioni per il collegamento sono disponibili sul sito di supporto di Nox Medical per l'applicazione da parte del paziente.



► Nota: Altri materiali sono disponibili sul sito web di Nox Medical: www.noxmedical.com

Avvertenze e precauzioni d'uso

- Avvertenza: il sistema Nox T3s **NON è certificato per il monitoraggio continuo** nei casi in cui un'anomalia del suo funzionamento possa causare lesioni o la morte del paziente.
- Attenzione: il registratore Nox T3s è conforme alla norma europea CEI 60601-1-2 relativa alla compatibilità elettromagnetica di apparecchiature e/o sistemi elettromedicali. Questa norma è concepita per fornire un'adeguata protezione contro pericolose interferenze in un impianto medico tipico. Tuttavia, a causa della proliferazione delle attrezzature di trasmissione a radiofrequenza e di altre sorgenti di rumore elettrico in ambienti sanitari e simili, gli alti livelli d'interferenza dovuti a prossimità eccessiva o alla potenza della sorgente potrebbero compromettere il funzionamento del dispositivo, compromettendo i segnali di registrazione e di conseguenza l'accuratezza dell'analisi dei dati e l'integrità del trattamento. Le apparecchiature elettromedicali necessitano di precauzioni speciali in materia di compatibilità elettromagnetica (CEM) e devono essere installate e messe in servizio in base alle informazioni su questa compatibilità riportate nella sezione "Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)" di questo manuale.
- Avvertenza: l'uso di accessori, trasduttori, sensori e cavi diversi da quelli elencati in questo manuale può comportare un aumento delle emissioni e/o una riduzione dell'immunità del sistema Nox T3s e causare lesioni all'operatore e/o al paziente.
- Avvertenza: i registratori Nox T3s non devono essere utilizzati nei pressi di altre apparecchiature o impilati su di esse. Qualora sia necessario utilizzare i registratori in prossimità di altre apparecchiature o impilarli su di esse, verificare che operino correttamente nella configurazione in cui si intende impiegarli e prevenire anomalie del loro funzionamento tali da poter causare lesioni all'operatore e/o al paziente.
- Avvertenza: il sistema Nox T3s è suscettibile di interferenza da parte di altre apparecchiature, anche qualora esse siano conformi ai requisiti di emissione del comitato internazionale speciale per le interferenze radio (CISPR). Questo può comportare il rischio di lesioni al paziente.
- Attenzione: esposizione alla radiazione da radiofrequenza.
- Avvertenza: le apparecchiature esterne e tutti i dispositivi ausiliari destinati alla connessione con l'ingresso del segnale, l'uscita del segnale o altri connettori devono essere conformi alle pertinenti norme di sicurezza del prodotto, ad esempio CEI 60950-1 per le apparecchiature informatiche e CEI 60601 per le apparecchiature elettromedicali, al fine di prevenire il rischio di scosse elettriche. Inoltre, tutte queste combinazioni – sistemi – devono essere conformi ai requisiti di sicurezza indicati nella norma generale CEI 60601-1, edizione 3/3.1/3.2, clausola 16. I dispositivi non conformi ai requisiti in materia di corrente di fuga della CEI 60601-1 verranno mantenuti all'esterno dell'ambiente dove si trova il paziente, ossia almeno a 1,5 metri dal

supporto del paziente. Chiunque connetta un dispositivo esterno al segnale in ingresso, uscita o altro connettore forma un sistema e quindi sarà responsabile della sua conformità ai requisiti. In caso di dubbio, contattare un tecnico medico qualificato o il proprio rappresentante locale.

- ▶ **Attenzione:** il registratore Nox T3s è progettato per poter essere utilizzato in modo sicuro da pazienti dotati di pacemaker purché i pacemaker stessi siano conformi alla norma EN 45502-2-1 sulla sicurezza di dispositivi medici impiantabili attivi. Requisiti particolari per dispositivi medici impiantabili attivi, destinati al trattamento della bradiaritmia (pacemaker cardiaci) e/o EN 45502-2-2 Dispositivi medici impiantabili attivi. Requisiti particolari per dispositivi medici impiantabili attivi, destinati al trattamento della tachiaritmia (inclusi i defibrillatori impiantabili). L'uso di pacemaker non conformi può compromettere il funzionamento del pacemaker stesso a causa dell'uso del registratore Nox T3s e causare lesioni al paziente. Tuttavia, prima di utilizzare il dispositivo con pazienti portatori di pacemaker, l'operatore deve consultare la documentazione fornita col pacemaker relativa alle sue certificazioni e ai requisiti d'uso o, se necessario, contattare il produttore.
- ▶ **Avvertenza:** non utilizzare il registratore Nox T3s e gli accessori durante esami radiografici. L'assorbimento energetico nel dispositivo, nei cavi o negli elettrodi potrebbe causare un riscaldamento eccessivo e provocare ustioni.
- ▶ **Avvertenza:** il registratore Nox T3s e i relativi accessori non sono indicati per l'uso con apparecchiature ad alta frequenza (HF). L'uso del dispositivo con apparecchiature ad alta frequenza (HF) potrebbe causare gravi lesioni al paziente.
- ▶ **Avvertenza:** il registratore Nox T3s non è a prova di defibrillatore. La mancata rimozione del dispositivo dal paziente prima della defibrillazione può portare alla creazione di un'alta densità di corrente in corrispondenza degli elettrodi, con conseguente rischio di ustioni e lesioni ai danni del paziente. La mancata rimozione del dispositivo del paziente prima della defibrillazione può inoltre alterare il flusso previsto della corrente, compromettendo l'efficienza della defibrillazione e causando lesioni o la morte del paziente.
- ▶ Non utilizzare alcuna parte del sistema Nox T3s, inclusi cavi paziente ed elettrodi, in un ambiente nel quale vengano effettuate risonanze magnetiche (RM). L'assorbimento di energia nei materiali conduttivi potrebbe causare un riscaldamento eccessivo e provocare ustioni.
- ▶ **Attenzione:** il registratore Nox T3s e le cinture RIP Nox devono essere indossati sopra gli indumenti per impedire reazioni allergiche ai materiali dell'apparecchiatura.
- ▶ **Avvertenza:** evitare il contatto accidentale tra le parti applicate sul lato paziente connesse ma inutilizzate e altre parti conduttive, comprese quelle collegate alla messa a terra di protezione. La mancata osservanza di questa avvertenza comporta il rischio di gravi lesioni per l'operatore e/o il paziente.
- ▶ **Avvertenza:** non utilizzare apparecchiature, sensori o accessori danneggiati. Questo può compromettere le prestazioni del sistema Nox T3s o causare lesioni al paziente e/o all'operatore.
- ▶ **Avvertenza:** il registratore Nox T3s e i suoi accessori devono essere rimossi dal paziente prima dell'uso del connettore USB al fine di impedire il rischio di scosse elettriche. Il connettore USB deve essere utilizzato solo per configurare il dispositivo e scaricare i dati dallo stesso.
- ▶ **Avvertenza:** il registratore Nox T3s non contiene parti la cui manutenzione o riparazione possa essere effettuata dall'utente. La manutenzione o riparazione del dispositivo può essere effettuata solo dal personale autorizzato. Eventuali operazioni di manutenzione o riparazione effettuate da personale non autorizzato possono compromettere l'accuratezza dell'analisi dei dati e pertanto l'integrità del trattamento. La garanzia decade se il registratore Nox T3s viene aperto (ad eccezione del vano batteria).
- ▶ **Avvertenza:** non è consentito di modificare il registratore Nox T3s o i relativi accessori. Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere il buon funzionamento del dispositivo e

causare gravi lesioni al paziente. Per garantire la sicurezza del paziente e l'utilizzo efficiente del sistema Nox T3s, utilizzare solo accessori omologati da Nox Medical. Vedere la sezione "Dispositivi e sensori compatibili".

- ▶ **Avvertenza:** rimuovere le batterie dal registratore Nox T3s se non si intende utilizzarlo per più di 30 giorni al fine di prevenire possibili danni dovuti a perdite delle batterie e il rischio di lievi ustioni ai danni dell'operatore o del paziente.
- ▶ **Avvertenza:** Non sterilizzare in autoclave o immergere il registratore Nox T3s o gli accessori in liquidi di qualsiasi tipo. L'ingresso di liquidi comporta il rischio di scosse elettriche.
- ▶ **Avvertenza:** il registratore Nox T3s NON è indicato per l'uso in presenza di una miscela anestetica infiammabile con aria o con ossigeno o protossido di azoto. Ciò potrebbe portare alla creazione di cariche elettrostatiche o temperature superiori ai limiti operativi, con conseguente rischio di scintille o ignizione, e di conseguenza ustioni o esplosioni.
- ▶ **Avvertenza:** come con tutta l'attrezzatura medica, predisporre con estrema cautela i cavi e le connessioni per evitare aggrovigliamenti o strozzature.
- ▶ **Attenzione:** le cinture RIP Nox devono aderire comodamente senza stringere troppo per evitare disagi al paziente.
- ▶ **Avvertenza:** Le cinture monouso RIP Nox, le cannule nasali Nox, i connettori per tubi filtro Nox, i tubi a pressione della maschera e il braccialetto Nonin sono monopaziente. L'uso di questi accessori con pazienti diversi comporta il rischio di infezioni crociate.
- ▶ **Avvertenza:** le cinture monouso RIP non vanno riutilizzate. Il riutilizzo delle cinture può compromettere la qualità dei segnali registrati e l'integrità del trattamento.
- ▶ **Avvertenza:** gli elettrodi vanno utilizzati solo da o previa consultazione con un operatore sanitario pratico del loro posizionamento e utilizzo. Non posizionare e utilizzare correttamente gli elettrodi può compromettere la registrazione dei dati e di conseguenza l'interpretazione e la diagnostica.
- ▶ **Avvertenza:** gli elettrodi devono essere applicati solo sulla pelle intatta e pulita (cioè ad esempio senza ferite aperte, lesioni, zone infiammate o infette) al fine di prevenire le infezioni.
- ▶ **Avvertenza:** Per prevenire la contaminazione incrociata, assicurarsi che il sensore morbido della SpO2 sia pulito dopo aver acceso il pulsossimetro Nonin 3150 BLE inserendo un dito (non quello del paziente) nel sensore. Per la pulizia del pulsossimetro, fare riferimento alle istruzioni che lo accompagnano.
- ▶ **Attenzione:** il registratore Nox T3s e i suoi accessori devono essere sempre trasportati nella borsa da trasporto in dotazione per garantire un'adeguata protezione e prevenire danni.



- ▶ Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso prestando particolare attenzione alle sezioni contrassegnate dal punto esclamativo.
- ▶ Per supporto operativo, in caso di errori dell'utente, eventi di sicurezza informatica o altri tipi di eventi, contattare support@noxmedical.com

Istruzioni per gli operatori

Si raccomanda agli operatori di contattare Nox Medical o i suoi rappresentanti di vendita

- per assistenza, ove necessario, nell'installazione, collegamento, uso o manutenzione del sistema Nox T3s, dei suoi accessori e (se del caso) dei sensori esterni e dispositivi ausiliari omologati per il sistema; o
- per segnalare anomalie di funzionamento o eventi imprevisti.

Le informazioni sul supporto e sui rappresentanti di vendita di Nox Medical sono disponibili sul sito web di Nox Medical: www.noxmedical.com/distributors.

Descrizione del Nox T3s

Il Nox T3s è un registratore di sonno ambulatoriale da indossare direttamente sul corpo.


I canali di ingresso e le funzioni integrate del dispositivo comprendono:

- 2 canali bipolari per la registrazione di elettrocardiogramma (ECG), elettromiografia (EMG), elettroencefalogramma (EEG) o elettrooculografia (EOG)
- 1 canale di massa
- 1 canale cannula/pressione per la registrazione della pressione nasale o alla maschera
- 2 canali dello sforzo respiratorio per la registrazione dei segnali dello sforzo ventilatorio addominale e toracico.
- Sensore di accelerazione 3-D integrato per la registrazione della posizione e dell'attività del paziente
- Microfono integrato per la registrazione dell'audio e del russamento
- Modulo Bluetooth® integrato per il supporto della connettività wireless consentendo al dispositivo di registrare segnali da dispositivi ausiliari compatibili
- Sensore luminoso incorporato per la registrazione della luce ambientale

Il registratore Nox T3s funziona con una batteria AA.

Interfaccia del Nox T3s

L'interfaccia del registratore Nox T3s è costituita da display, pulsanti, ingressi/connettori per sensori e un connettore USB. Il connettore USB si trova sotto al coperchio della batteria e si collega a un cavo USB tipo C per la configurazione del dispositivo e il download dei dati. Per una descrizione dettagliata, consultare le figure e tabelle sottostanti.

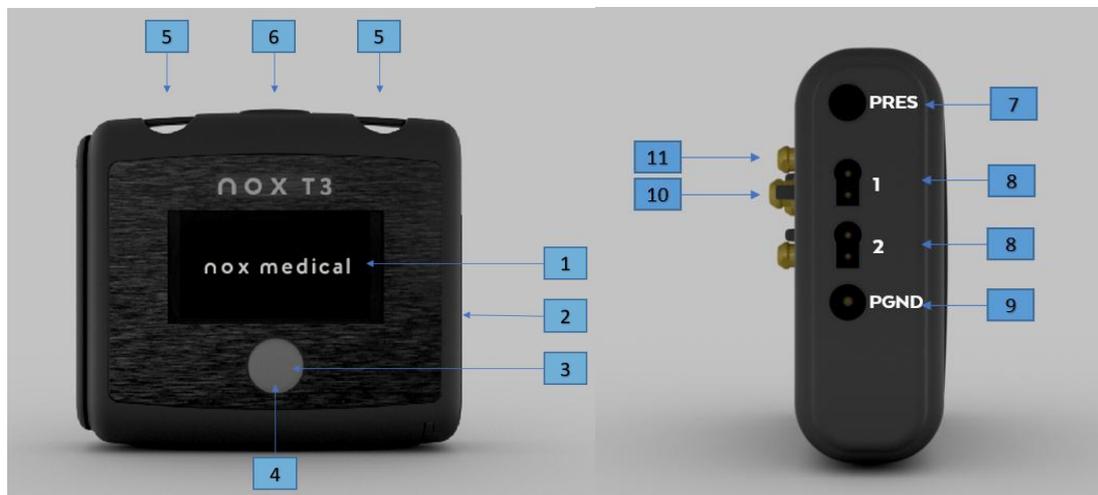

NUMERO	FUNZIONE
1	Display
2	Coperchio batteria – Copre la batteria e il connettore USB
3	Pulsante a pressione


- 4 Indicatore luminoso dello stato del dispositivo
 Sensore luminoso situato sotto il pulsante trasparente schermato
- 5 2 circuiti con fascetta graffettata (clip strap)
- 6 Microfono – Per la registrazione dei rumori respiratori
- 7 Blocco pressione (indicato da "PRES") – permette di collegare la cannula nasale esterna/il tubo di pressione della maschera
- 8 Canali 1 e 2 (indicati da "1" e "2") - Ingressi bipolari touch-proof
- 9 Ingresso di terra di riferimento per i canali 1 e 2 (indicato da "PGND") - Ingressi unipolari touch-proof
- 10 2 elettrodi metallici – da connettere al cavo dell'addome
- 11 2 elettrodi metallici – da connettere alla cintura toracica RIP

Utilizzo del Nox T3s

Il registratore Nox T3s viene azionato da un pulsante situato sulla parte frontale del dispositivo. Premere il pulsante attiva il display. Il display si spegne automaticamente dopo due minuti.

Collegamento del Nox T3s al computer

Per collegare il registratore Nox T3s al computer, è necessario accedere al connettore USB presente sul dispositivo. Il connettore USB è collocato sotto il coperchio della batteria, per tenerlo al riparo dalla portata dei bambini. Per aprire il coperchio del vano batteria, premere l'apposita chiave in dotazione con il kit di sistema Nox T3s sul perno del coperchio e far scorrere il coperchio verso il basso. Il Nox T3s si collega al computer tramite un cavo USB tipo C. Non è necessario inserire la batteria mentre il dispositivo è collegato al computer.

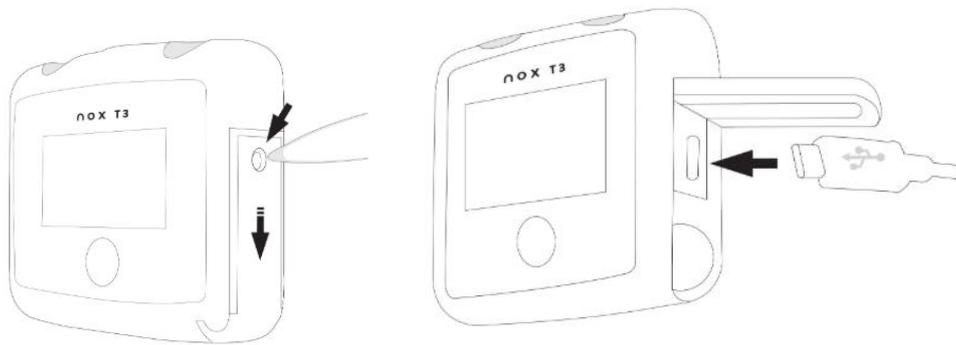

Quando il registratore Nox T3s è collegato al computer, il display del dispositivo s'illumina e informa l'utente dell'avvenuto collegamento.

Per ambienti IT che limitano l'accesso della porta USB a periferiche USB, ai seguenti id fornitore (VID) e id prodotto (PID) va permesso di accedere alla rete per comunicare con i dispositivi di registrazione Nox: VID=0x1E0A, PID=0x1002.

Configurazione e download dal Nox T3s

Per eseguire il download di una registrazione o configurare un registratore Nox T3s, è necessario avviare il software Noxturnal (versione 6.0 o successiva) e collegare il dispositivo al computer. Per maggiori informazioni su come eseguire queste operazioni, fare riferimento al manuale Noxturnal.

Dopo l'uso, rimuovere il dispositivo dal software Noxturnal e scollegare il cavo USB tipo C. Inserire la batteria e chiudere il vano batteria premendo con delicatezza il coperchio verso il dispositivo, quindi farlo scorrere verso l'alto per riportarlo nella posizione iniziale.

Avvio/arresto collegando le cinture RIP sul Nox T3s

Se il registratore Nox T3s è configurato per avviare la registrazione connettendo le cinture Nox RIP monouso, la registrazione comincerà quando si connette una cintura le cinture RIP Nox Thorax. Il dispositivo suggerisce di "Connettere le cinture per avviare la registrazione". Quando la cintura RIP Nox Thorax è connessa viene visualizzata la "Durata della registrazione" e appare il simbolo REC sulla parte superiore dello schermo. Una volta che il display si è spento, l'indicatore luminoso sotto il pulsante inizia a lampeggiare in verde per segnalare che è in corso una registrazione. Se la cintura RIP Nox Thorax viene scollegata per più di 30 secondi, La registrazione si fermerà.



Avvio/arresto premendo il pulsante sul Nox T3s (manuale)

Se il registratore Nox T3s è stato configurato per avviare la registrazione manualmente premendo il pulsante, premere il pulsante per avviare manualmente una registrazione. Premendo il pulsante si attiva il display. Il dispositivo suggerisce di "Tenere premuto il pulsante per avviare la registrazione". Seguire le indicazioni fino a quando sul display non comparirà la frase "Durata registrazione". Notare che per visualizzare la durata della registrazione il pulsante deve essere tenuto premuto per 4-5 secondi. A questo punto il dispositivo avrà iniziato a registrare i dati e il simbolo REC comparirà nella parte superiore del display. Una volta che il display si è spento, l'indicatore luminoso sotto il pulsante inizia a lampeggiare in verde per segnalare che è in corso una registrazione. Utilizzare la stessa procedura per interrompere manualmente la registrazione.



Se durante la configurazione del dispositivo è stata specificata la durata della registrazione, la registrazione sarà interrotta automaticamente dopo il termine indicato.

Avvio del Nox T3s a un'ora prestabilita

Se il registratore Nox T3s è configurato per l'avvio automatico della registrazione a un'ora prestabilita, per avviare la registrazione non dovrà essere eseguita alcuna operazione. Premere il pulsante prima dell'avvio di una registrazione fa sì che venga visualizzato il conto alla rovescia del tempo restante prima della registrazione. Se la registrazione è iniziata, il display mostra la durata corrente della registrazione e il simbolo REC appare nella parte superiore del display.



Stato del Nox T3s

Indicatore luminoso

Quando una registrazione è in corso e il registratore Nox T3s funziona in maniera regolare, l'indicatore luminoso che lampeggia sul dispositivo è verde. In presenza di avvisi, l'indicatore luminoso diventa giallo e lampeggia. Gli avvisi possono riferirsi a:

- Batteria scarica
- Dispositivo senza licenza.

Visualizzazioni

Il display visualizza informazioni sulla durata della registrazione, sullo stato della registrazione e sulle connessioni del dispositivo. Se il display è spento, è possibile riattivarlo premendo il pulsante. Premere di nuovo il pulsante consente di scorrere tra le visualizzazioni disponibili. Il display si spegnerà di nuovo automaticamente dopo 20 secondi circa di inattività.

Il display visualizza informazioni su connessioni del dispositivo, ora e stato della batteria.

1. Il simbolo Bluetooth e una "X" o un segno di spunta "" sono visibili in tutte le visualizzazioni. ✓ Questo simbolo mostra lo stato della connessione Bluetooth con l'ossimetro. Una "X" indica che la connessione Bluetooth è assente, mentre il segno di spunta "" indica che la connessione è presente.
2. L'orologio del dispositivo. Quando il Nox T3s è configurato, l'ora del registratore viene sincronizzata con quella del PC e l'orologio compare nella parte superiore del display.



3. Nell'angolo in alto a destra compare lo stato della batteria. La barra della batteria appare piena se le batterie del dispositivo sono nuove.

La prima visualizzazione che compare dopo l'accensione del dispositivo mostra le informazioni sulla registrazione pianificata o in corso, come illustrato nelle sezioni precedenti. La seconda visualizzazione mostra lo stato della connessione dell'ossimetro.

1. Una "X" accanto a "SpO₂" indica che l'ossimetro non è connesso al dispositivo. ✓Una volta connesso un ossimetro, comparirà il segno di spunta "✓".
2. L'indirizzo del dispositivo Bluetooth (BDA) dell'ossimetro a cui il dispositivo sta tentando di connettersi o a cui è connesso.



Il display **Qualità dello studio** mostra gli indicatori dello studio avvenuto con successo. L'indicatore dello studio avvenuto con successo aiuta a determinare se la registrazione comprende i segnali necessari per l'analisi respiratoria. Nel caso di un'indicazione di studio non completato, il paziente può eseguire registrazioni aggiuntive senza aver bisogno di restituire o riconfigurare il dispositivo. Per attivare l'indicatore dello studio avvenuto con successo, andare su Impostazioni software NOXTURNAL -> Opzioni dispositivo -> Indicatore dello studio avvenuto con successo. Se è attivato, il display Qualità dello studio è il terzo display.

Ciascun quadrato rappresenta una registrazione, il numero di quadrati corrisponde al numero di registrazioni. Un quadrato vuoto rappresenta una registrazione ancora da eseguire. Un quadrato riempito con un segno di spunta o una croce rappresenta una registrazione con studio avvenuto con successo. L'indicatore di studio avvenuto con successo viene segnato quando si arresta la registrazione. Per la valutazione dell'indicatore di studio avvenuto con successo, la lunghezza minima della registrazione è 15 minuti.

Se una o più delle registrazioni programmate non va a buon fine, viene aggiunta automaticamente un'ulteriore registrazione programmata.

1. Un quadrato con un segno di spunta "✓" indica uno studio avvenuto con successo.
2. Un quadrato con una X indica uno studio non andato a buon fine.
3. Un quadrato vuoto rappresenta una registrazione ancora da eseguire.



La valutazione dell'indicatore dello studio avvenuto con successo si basa sui segnali respiratori (cannula nasale, RIP addominale e toracico) e sul segnale SpO2. Se 2 segnali respiratori su 3 e il segnale SpO2 sono conformi alle soglie di qualità predeterminate per la specifica soglia di durata (4 ore o 6 ore) impostata nella configurazione delle registrazioni, dove 4 ore è l'impostazione di default, l'indicatore di studio avvenuto con successo per la registrazione viene marcato con un segno di spunta.

Altre visualizzazioni:

Quando il registratore Nox T3s è collegato a un computer tramite cavo USB-C, viene visualizzata un'immagine che lo indica.



Collegamento del paziente al Nox T3s

Nella maggior parte dei casi il collegamento del registratore Nox T3s viene eseguito dal paziente a casa propria attenendosi alle istruzioni ricevute. Si consiglia che un operatore sanitario dotato delle necessarie competenze e qualifiche dimostri al paziente o a chi lo assiste (nel caso di pazienti pediatrici) come fare ad effettuare il collegamento. Le istruzioni per il collegamento sono disponibili sul sito di supporto di Nox Medical per l'applicazione da parte del paziente.

I seguenti punti vanno illustrati al paziente o all'assistente (nel caso di pazienti pediatrici):

1. Collegamento del registratore Nox T3s e dei sensori.
2. Verifica del collegamento dei sensori.
3. Avvio e arresto di una registrazione (se si utilizza la modalità di registrazione manuale)
4. Indicazioni dello stato sul display.

È importante ricordare al paziente o all'assistente di seguire le istruzioni fornite prima di procedere con la registrazione.

Prima di rimandare a casa il paziente:

1. Assicurarsi che il registratore Nox T3s sia stato preparato correttamente.
2. Assicurarsi che la borsa da trasporto contenga tutta l'attrezzatura necessaria per eseguire la registrazione a casa del paziente, comprese le batterie.



- ▶ Non consentire mai ai bambini di collegare il Nox T3s da soli.
- ▶ Avvertenza: non utilizzare apparecchiature, sensori o accessori danneggiati. Questo può compromettere le prestazioni del sistema Nox T3 o causare lesioni al paziente e/o all'operatore.
- ▶ Avvertenza: come con tutta l'attrezzatura medica, predisporre con estrema cautela i cavi e le connessioni per evitare aggrovigliamenti o strozzature.
- ▶ Attenzione: il registratore Nox T3s e i suoi accessori devono essere sempre trasportati nella borsa da trasporto in dotazione per garantire un'adeguata protezione e prevenire danni.

Inserimento di una batteria nel Nox T3s

L'elenco sottostante viene fornito per aiutare l'utente nella scelta del tipo di batteria più adatto per uno studio con il Nox T3s:


- Le batterie alcaline possono registrare da 8 a 16 ore, secondo il tipo di batteria.
- Le batterie al litio possono registrare da 20 a 33 ore, secondo il tipo di studio e di batteria.
- Le batterie al litio sono ideali per le registrazioni notturne multiple e possono registrare tre o più notti senza essere sostituite.
- Le batterie ricaricabili NiMH possono registrare da 1 a 1,5 ore con una capacità di 200 mAh. Una batteria standard da 2000 mAh può così registrare da 10 a 15 ore.



- ▶ Nota: utilizzare sempre batterie nuove o completamente cariche per ogni registrazione onde non rischiare di dover ripetere lo studio del sonno.
- ▶ Nota: tutte le batterie al litio utilizzate con il registratore Nox T3s devono essere conformi allo standard CEI 60086-4 Batterie primarie - Parte 4: Sicurezza delle batterie al litio.

- ▶ Nota: le durate delle registrazioni elencate di seguito dipendono dalla qualità delle batterie utilizzate.
- ▶ Nota: Ulteriori informazioni sulle registrazioni nell'arco di più notti sono disponibili sul sito di supporto di Nox Medical.

Prima di avviare la registrazione, assicurarsi che il registratore Nox T3s sia provvisto di una batteria nuova o completamente carica. Per inserire una batteria nuova, seguire queste indicazioni:

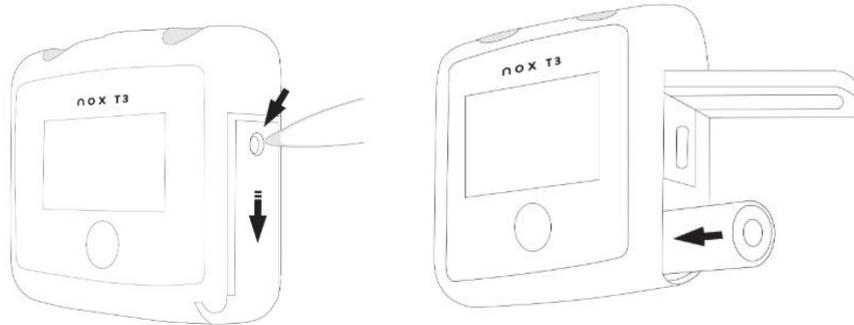

1. Aprire il vano batteria premendo sul perno del coperchio con l'apposita chiave in dotazione con il kit del sistema Nox T3s, quindi far scorrere il coperchio verso il basso.
2. Inserire una batteria AA nel vano avendo cura di allineare i poli come mostrato sul retro del dispositivo (polo positivo (+) contro il coperchio della batteria).
3. Chiudere il vano batteria premendo con delicatezza il coperchio verso il dispositivo, quindi farlo scorrere verso l'alto per riportarlo nella posizione iniziale. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso correttamente.

Lo stato della batteria può essere controllato attivando il dispositivo. L'indicatore di stato della batteria nell'angolo in alto a destra sul display del dispositivo consente di verificare lo stato della batteria. Se la batteria si scarica durante una registrazione, il dispositivo interrompe automaticamente la registrazione.


Collegamento del Nox T3s e delle cinture RIP Nox



- ▶ **Attenzione:** il registratore Nox T3s e le cinture RIP Nox monouso devono essere indossati sopra gli indumenti per impedire reazioni allergiche ai materiali dell'apparecchiatura.
- ▶ **Avvertenza:** le cinture RIP Nox monouso sono monopaziente e non vanno riutilizzate. Il riutilizzo delle cinture RIP Nox monouso può compromettere la qualità dei segnali registrati e l'integrità del trattamento. L'utilizzo della stessa cintura RIP Nox monouso su più di un paziente può provocare infezioni crociate.


Fase 1

Agganciare le clip attaccate al registratore Nox T3s alla camicia del paziente.

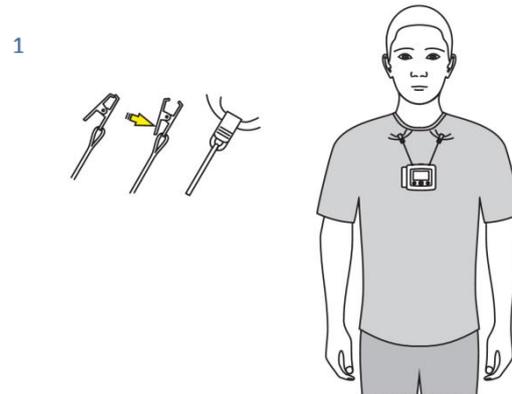


Da fase 2 a fase 4

- Collegare il cavo addominale Nox al retro del dispositivo.
- Posizionare una cintura RIP Nox monouso intorno al torace e agganciare le estremità al pannello posteriore del dispositivo.
- Regolare la lunghezza del cavo addominale Nox secondo necessità avvolgendolo intorno all'unità di collegamento addominale. Posizionare una cintura RIP Nox monouso intorno all'addome e agganciarla in posizione.

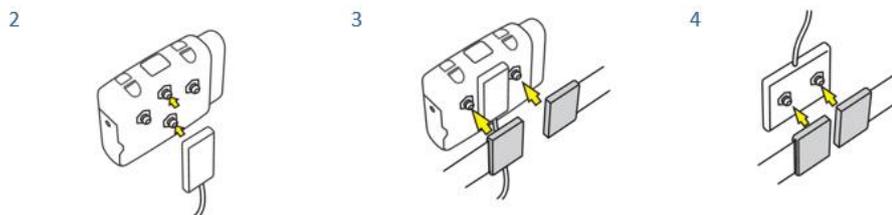

Fase 5

Il collegamento del registratore Nox T3s e delle cinture RIP Nox monouso è ora completato.

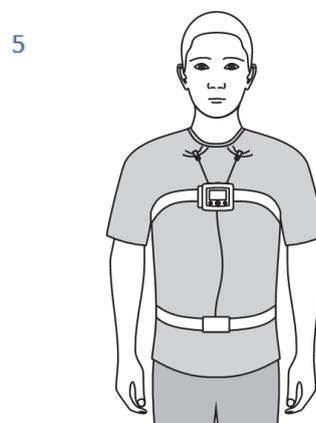


Regolazione delle cinture RIP Nox



- ▶ **Attenzione:** le cinture RIP Nox monouso devono aderire comodamente senza stringere troppo per evitare disagi al paziente.
- ▶ **Nota:** nella maggioranza dei pazienti le cinture RIP Nox monouso non vanno regolate se è stata scelta la misura giusta in funzione della circonferenza dell'addome del soggetto e/o del suo indice di massa corporea (IMC). Per istruzioni dettagliate consultare le tabelle per la scelta della misura della cintura RIP Nox monouso che accompagnano il prodotto.

Sistemare le cinture RIP Nox monouso intorno alla vita e al torace del paziente regolandone la lunghezza usando il passante su entrambe le estremità in modo che ogni cintura copra circa i due terzi della circonferenza del paziente quando non è in tensione. La lunghezza è fissata da ganci sul connettore in plastica della cintura.

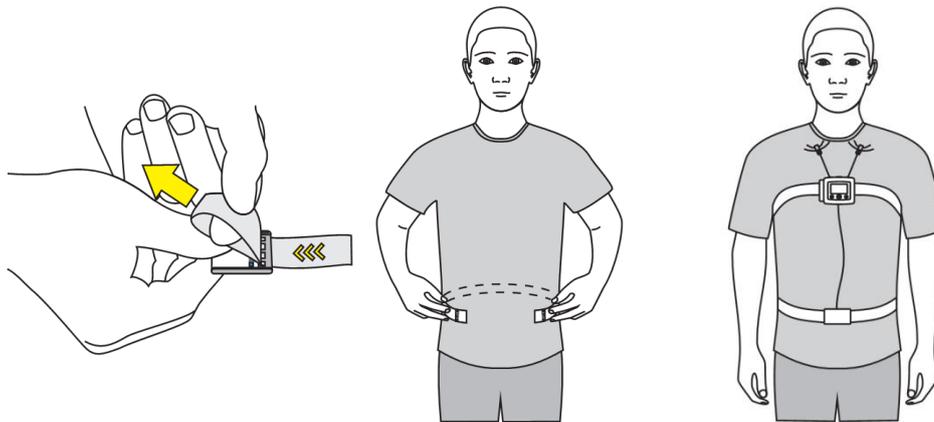


Collegamento della cannula nasale Nox




- ▶ **Avvertenza:** le cannule nasali Nox sono monopaziente. L'utilizzo della stessa cannula nasale su più di un paziente può causare rischi di infezione crociata.
- ▶ **Nota:** è possibile utilizzare del nastro medico per fissare la cannula sulle guance del paziente e impedirne eventuali movimenti.
- ▶ **Nota:** la cannula nasale Nox con filtro è dotata di filtro idrofobico integrato ed è il sistema migliore per misurare il flusso d'aria nasale e il russamento in quanto è concepita per perfezionare la qualità del segnale e adattarsi direttamente al registratore Nox T3s. Se si utilizza una cannula non filtrata con raccordo Luer Lock, sarà necessario utilizzare un connettore del tubo filtro di Nox Medical in grado di interfacciarsi con il registratore Nox T3s.

Fase 1 Inserire delicatamente le derivazioni della cannula all'interno delle narici. Le derivazioni devono puntare verso il basso.

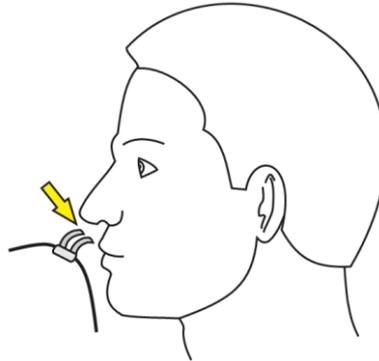

Fase 2 Far passare il tubicino della cannula sopra le orecchie e posizionarlo sotto il mento.

Fase 3 Far scorrere delicatamente il dispositivo di fissaggio sotto il mento per mantenere il tubicino della cannula in posizione.

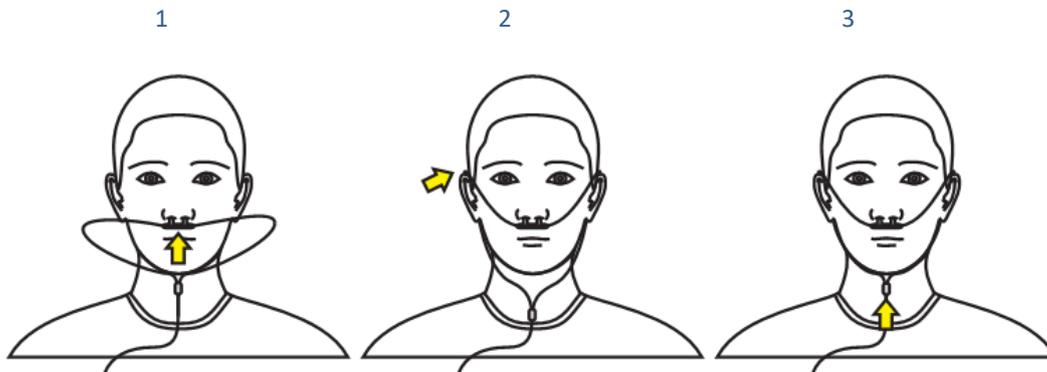

Consultare la sezione "Dispositivi e sensori compatibili" per informazioni sui tipi di cannule nasali Nox omologati per il dispositivo Nox T3s.

Misurazione della pressione della maschera



- ▶ **Avvertenza:** i tubi di pressione della maschera e i connettori del tubo filtro Nox sono monopaziente. L'utilizzo degli stessi tubi di pressione della maschera e connettori per i tubi filtro su più di un paziente può causare rischi di infezione crociata.
- ▶ **Nota:** il tubo di pressione della maschera può essere collegato solo al blocco pressione sul registratore Nox T3s utilizzando il connettore del tubo filtro Nox.

Il tubo di pressione della maschera è utilizzato per collegare le maschere a pressione positiva alle vie aeree (PAP) e rilevarne la pressione. Il tubo di pressione si collega al blocco pressione sul registratore Nox T3s tramite un connettore del tubo filtro di Nox Medical.

Consultare la sezione "Dispositivi e sensori compatibili" per informazioni sui tipi di tubi di pressione della maschera omologati per il sistema Nox T3s.

Rilevamento dei segnali ExG



- ▶ Avvertenza: gli elettrodi vanno utilizzati solo da o previa consultazione con un operatore sanitario pratico del loro posizionamento e utilizzo. Non posizionare e utilizzare correttamente gli elettrodi può compromettere la registrazione dei dati e di conseguenza l'interpretazione e la diagnostica.
- ▶ Avvertenza: gli elettrodi devono essere applicati solo sulla pelle intatta e pulita (cioè ad esempio senza ferite aperte, lesioni, zone infiammate o infette) al fine di prevenire le infezioni.
- ▶ Avvertenza: assicurarsi che le parti conduttive degli elettrodi e i relativi connettori, compresi l'elettrodo neutro, non entrino in contatto con altre parti conduttive compresa la messa a terra onde prevenire il rischio di gravi lesioni per l'operatore e/o il paziente.

Il registratore Nox T3s è in grado di registrare qualsiasi combinazione di due canali ExG, cioè EMG, EOG, EEG o ECG. I cavi degli elettrodi si collegano agli ingressi bipolari touch-proof del registratore Nox T3s. Gli elettrodi vengono applicati su aree specifiche del corpo, a seconda del tipo di registrazione.

Consultare la sezione "Dispositivi e sensori compatibili" per informazioni sui tipi di elettrodi e cavi omologati per il dispositivo Nox T3s.

Misurazione del polso e della saturazione dell'ossigeno mediante il pulsossimetro Nonin 3150 BLE



- ▶ Avvertenza: il sistema Nox T3s **NON è certificato per il monitoraggio continuo** nei casi in cui un'anomalia del suo funzionamento possa causare lesioni o la morte del paziente.
- ▶ Avvertenza: evitare pressioni eccessive sul sito di applicazione del sensore poiché potrebbero causare lesioni alla pelle sotto il sensore.
- ▶ Avvertenza: per evitare anomalie nel funzionamento del sistema e/o lesioni al paziente, verificare la compatibilità tra registratore Nox T3s, ossimetro, sensori e accessori prima dell'uso.
- ▶ Avvertenza: prima di sostituire le batterie, assicurarsi che l'ossimetro sia spento e che il sensore non sia applicato a un dito.
- ▶ Attenzione: l'ossimetro è dotato di un software di compensazione del movimento che riduce al minimo il rischio che un artefatto dovuto al movimento venga interpretato erroneamente come una buona qualità del polso. In alcune circostanze, tuttavia, il dispositivo può ugualmente interpretare il movimento come una buona qualità del polso.
- ▶ Attenzione: per evitare il rischio che i dati del paziente vengano confusi o interpretati erroneamente nella trasmissione tramite Bluetooth, verificare che l'ossimetro sia associato al registratore Nox T3s corretto.
- ▶ Attenzione: non stringere eccessivamente l'ossimetro intorno al polso del paziente. Potrebbe causare fastidio al paziente e determinare una registrazione errata.
- ▶ Attenzione: non utilizzare un sensore danneggiato. Se il sensore è comunque danneggiato, interrompere immediatamente il suo utilizzo e sostituirlo.
- ▶ Attenzione: l'ossimetro è concepito per determinare la percentuale di saturazione dell'ossigeno arterioso dell'emoglobina funzionale. Tra i fattori che

possono degradare le prestazioni del pulsossimetro o incidere sull'accuratezza della misurazione segnaliamo i seguenti:

- ambiente troppo luminoso
 - eccessivo movimento
 - interferenza elettrochirurgica
 - limitatori del flusso sanguigno (cateteri arteriosi, sfigmomanometri, linee di infusione, ecc.)
 - umidità nel sensore
 - sensore applicato in modo scorretto
 - tipo di sensore errato
 - qualità polso scadente
 - pulsazioni venose
 - anemia o concentrazioni emoglobiniche basse
 - coloranti cardiogreen e altri coloranti cardiovascolari
 - carbosiemoglobina
 - metemoglobina
 - emoglobina disfunzionale
 - unghie artificiali o smalto per unghie
 - residui (come sangue secco, sporcizia, grasso, olio) lungo il percorso della luce
- ▶ Attenzione: quando si utilizza l'ossimetro in casa, proteggerlo da pelucchi e polvere.
- ▶ Attenzione: il pulsossimetro potrebbe non funzionare quando la circolazione è ridotta. Scaldare o strofinare il dito o riposizionare il sensore.
- ▶ Nota: consultare le istruzioni delle terze parti in dotazione con il pulsossimetro e/o il sensore ossimetrico per il tempo massimo di applicazione su una singola area.
- ▶ Nota: consultare le istruzioni delle terze parti in dotazione con il pulsossimetro e il sensore ossimetrico per ulteriori avvertenze e messaggi di precauzione.
- ▶ Avvertenza: il braccialetto Nonin è esclusivamente monopaziente. Il braccialetto può essere pulito (fare riferimento alle istruzioni in dotazione con il pulsossimetro per le istruzioni sulla pulizia), ma successivamente andrà applicato allo stesso paziente e non a un paziente diverso.
- ▶ Le batterie possono perdere o esplodere se utilizzate o smaltite in modo improprio. Rimuovere le batterie se il dispositivo non sarà utilizzato per più di 30 giorni. Non utilizzare insieme batterie di diverso tipo. Non utilizzare batterie completamente cariche insieme a batterie parzialmente cariche. Queste azioni potrebbero causare perdite dalle batterie.

Il registratore Nox T3s può comunicare con un pulsossimetro ausiliario Bluetooth® per registrare i livelli di saturazione dell'ossigeno (SpO₂), la frequenza del polso e i dati pletismografici.

Fare riferimento alla sezione "Dispositivi e sensori compatibili" per informazioni sui tipi di pulsossimetri e sensori supportati dal sistema Nox T3s.

Inserimento delle batterie nel pulsossimetro Nonin 3150 BLE

Per la sostituzione delle batterie del pulsossimetro Nonin 3150 BLE durante l'uso, fare riferimento alle istruzioni che lo accompagnano.




- ▶ Nota: Le batterie monouso hanno un'autonomia massima di 48 ore, pertanto è importante ricordare il numero di misurazioni eseguite con l'ossimetro. Si consiglia di cambiare le batterie dopo 2-3 registrazioni, a seconda della qualità delle batterie utilizzate.
- ▶ Nota: se si utilizzano batterie ricaricabili, è consigliabile sostituirle prima di ogni registrazione.

Scegliere la dimensione del sensore ossimetrico

Sensore morbido riutilizzabile per pulsossimetro Nonin

Le raccomandazioni relative alla dimensione del sensore morbido si basano sull'altezza o spessore del dito. Il valore dell'altezza o spessore del dito (H) viene misurato come indicato nella seguente figura.



Per un valore tra 7,5 mm e 12,5 mm, si consiglia di scegliere il sensore piccolo.

Per un valore tra 10,5 mm e 19,0 mm, si consiglia di scegliere il sensore medio.

Per un valore tra 12,5 mm e 25,5 mm, si consiglia di scegliere il sensore grande.


Collegamento del pulsossimetro Nonin 3150 BLE e del sensore flessibile

Il pacchetto dell'ossimetro Nonin 3150 BLE WristOx₂ che accompagna i kit del sistema Nox T3s comprende:

- Pulsossimetro WristOx₂® modello 3150 BLE
- Sensore morbido riutilizzabile, modello 8000SM-WO2
- 1 braccialetto
- Manuale dell'operatore su CD-ROM

Da fase 1 a fase 4

1. Separare l'estremità corta del braccialetto dall'estremità lunga.
2. Inserire l'estremità corta nei passanti dell'ossimetro.
3. Posizionare la sonda tra l'estremità corta e quella lunga del braccialetto. Fissare l'estremità lunga a quella corta per assicurare il braccialetto sull'ossimetro ed il cavo sonda tra le due estremità.
4. L'ossimetro è così fissato al braccialetto ed il cavo sonda è fissato tra le due estremità, formando un passante che impedisce di tirare direttamente il connettore.

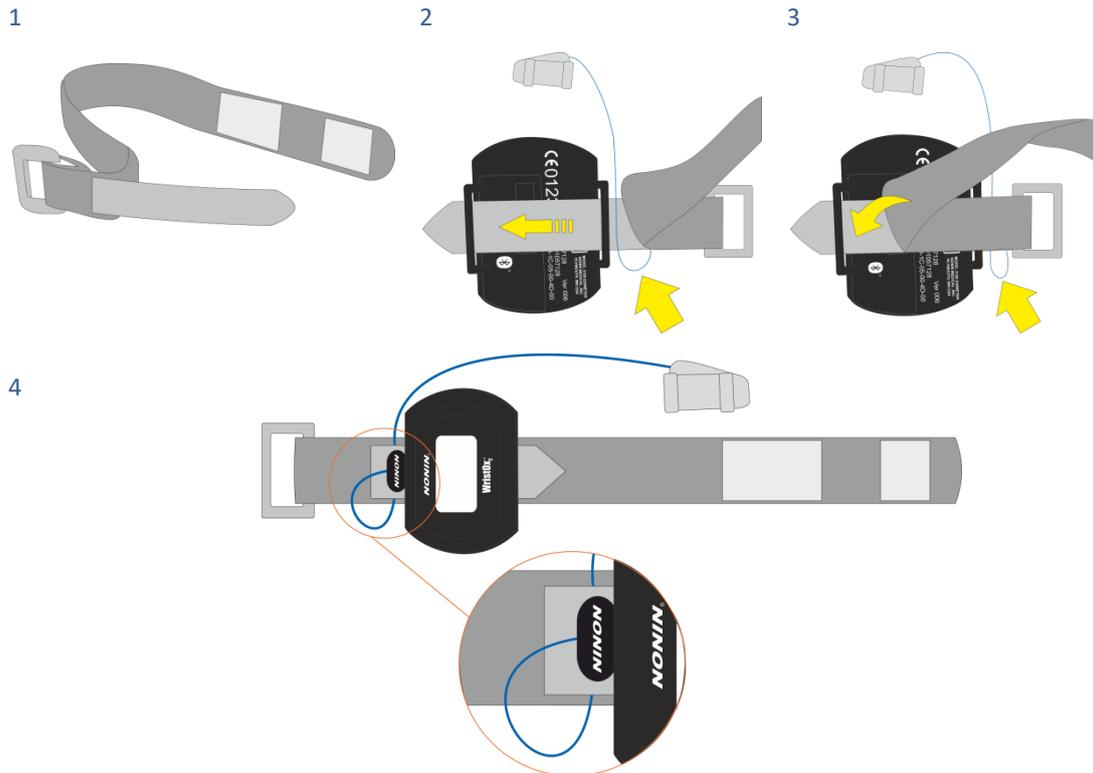


Da fase 5 a fase 6



► Nota: per impedire la caduta del sensore dell'ossimetro, assicurare il cavo con nastro per uso medico.

5. Fissare il braccialetto sul polso del paziente.
6. Posizionare la sonda su un dito.

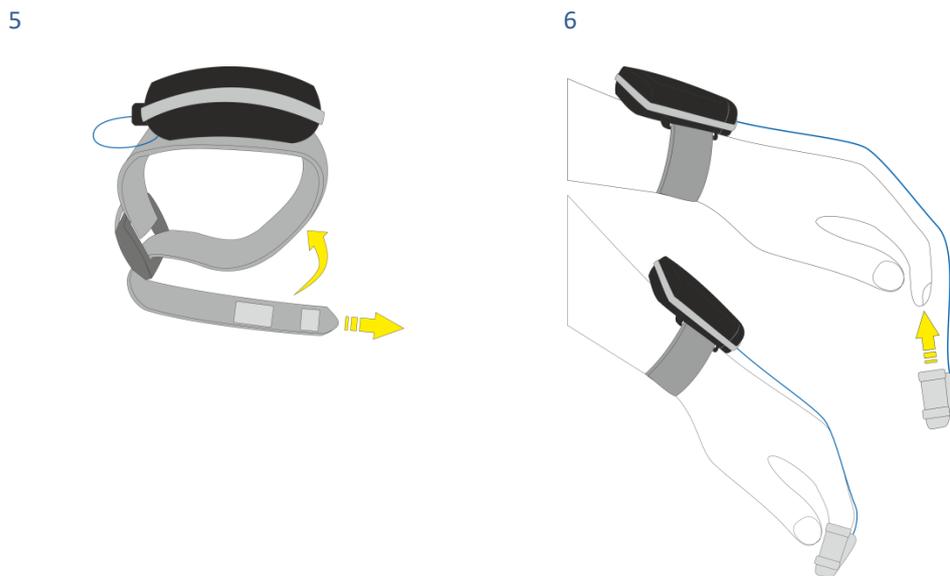

Connessione tra il pulsossimetro Nonin 3150 BLE e il registratore Nox T3s

Prima di poter inviare il registratore Nox T3s e gli accessori per una registrazione ambulatoriale, è necessario assicurarsi che sia stata stabilita una connessione tra il registratore Nox T3s e l'ossimetro. L'associazione del registratore Nox T3s e dell'ossimetro viene eseguita durante la configurazione del dispositivo all'interno del software Noxturnal. Attenersi alle seguenti istruzioni per stabilire la connessione tra il registratore Nox T3s e l'ossimetro Nonin 3150 BLE.



Nota: il registratore Nox T3s è in grado di connettersi unicamente agli ossimetri Nonin 3150 BLE e non supporta il collegamento agli ossimetri Nonin 3150 Classic. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del supporto di Nox Medical.

Procedura di associazione

Fase 1. Inserimento delle batterie

Per prima cosa, inserire batterie nuove/completamente cariche nel pulsossimetro Nonin 3150 BLE.


Fase 2. Accensione del pulsossimetro Nonin 3150 BLE

Accendere il pulsossimetro Nonin 3150 BLE premendo il pulsante di attivazione grigio (cerchiato in rosso nella figura sottostante) sulla parte superiore del dispositivo. Il display si accenderà.




Fase 3 - Connettere il registratore Nox T3s con un cavo USB e seguire la configurazione in Noxturnal.


Inserire il numero BDA del pulsossimetro presente sul retro dell'ossimetro Nonin 3150 BLE.

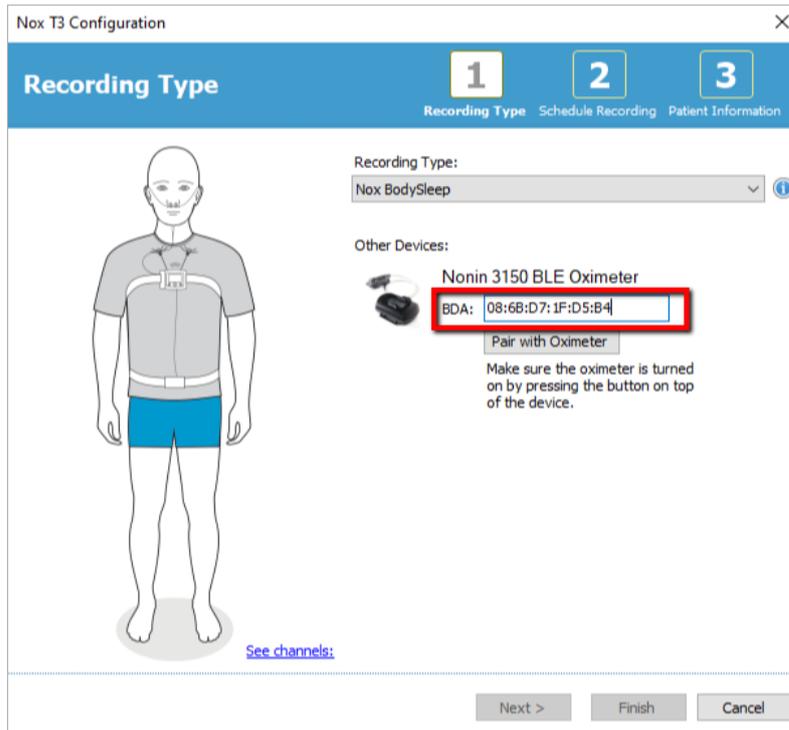

Fare clic su Associa all'ossimetro. L'associazione avrà esito positivo...

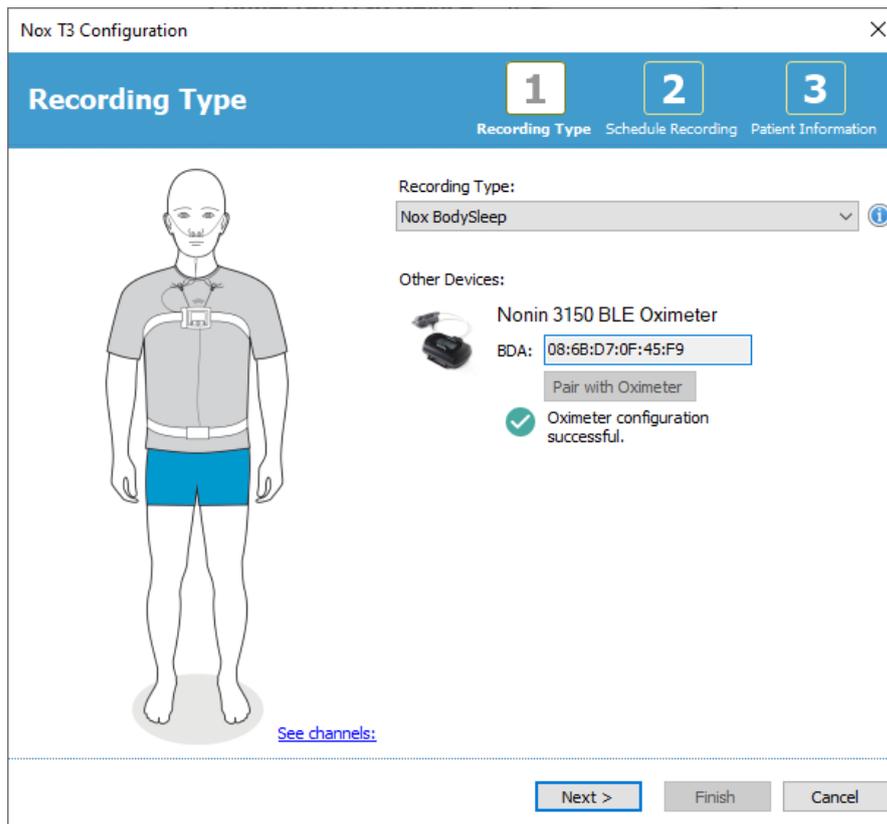

oppure negativo.

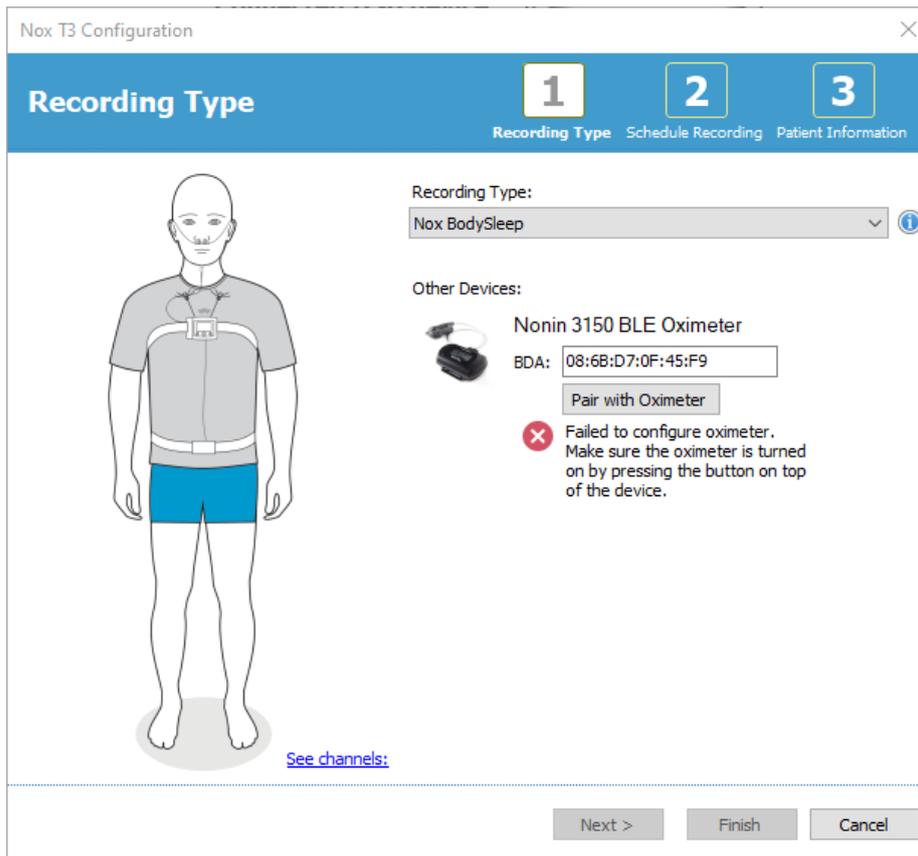

Se l'operazione non riesce, seguire i suggerimenti per la risoluzione dei problemi nel software o vedere i suggerimenti sottostanti.

Fase 4. Modalità di riattivazione Bluetooth.

Se l'associazione ha avuto esito positivo durante la fase di configurazione in NoxT3, il Nonin 3150 BLE si troverà in modalità di riattivazione Bluetooth. Questo viene indicato dal lampeggiare del simbolo Bluetooth a intervalli regolari nel corso dello studio.



Il Nonin 3150 BLE si accenderà quando il registratore Nox T3s avvia uno studio (sia che l'avvio sia manuale o programmato).

Il Nox T3s è ora pronto per essere imballato e consegnato/spedito al cliente.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi durante l'associazione dell'ossimetro in Noxturnal

Numero BDA errato:

Se l'operazione fallisce, controllare il numero BDA del dispositivo e assicurarsi che corrisponda al numero sull'ossimetro Nonin 3150 BLE.



Numero BDA corretto ma dispositivi non associati

- Riavviare l'ossimetro togliendo e rimettendo le sue batterie. Tenere premuto quindi il pulsante di attivazione grigio per accendere il dispositivo. Riprendere la procedura di associazione dalla fase 3 illustrata sopra.
- Riavviare il Nox T3s scollegandolo dal computer e ricollegandolo. Riprendere la procedura di associazione dalla fase 3 illustrata sopra.



Nota: questa associazione funziona solo con gli ossimetri Nonin 3150 BLE. Gli ossimetri Nonin 3150 Classic non sono supportati. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina del supporto di Nox Medical.

Nota: se il problema si ripete di frequente, potrebbe essere necessario inviare l'ossimetro a un centro di assistenza per riparazione.

Risoluzione dei problemi relativi alla connessione dell'ossimetro durante il collegamento (dopo aver eseguito l'associazione in Noxturnal)

Verificare che il numero BDA dell'ossimetro utilizzato corrisponda a quello utilizzato per configurare il registratore Nox T3s. Il numero BDA utilizzato per la configurazione del Nox T3s si trova nella visualizzazione del dispositivo che mostra lo stato di connessione dell'ossimetro. Il numero BDA dell'ossimetro si trova sul lato posteriore dell'ossimetro stesso.



Qualora il numero sul dispositivo non corrisponda a quello dell'ossimetro, sarà necessario riconfigurare il Nox T3s all'interno del software Noxturnal e inserire il numero BDA direttamente nel software, come nel passaggio 3 della procedura di associazione.

Il numero BDA è corretto ma la visualizzazione dello stato dell'ossimetro mostra ancora una X:



Questo indica che l'associazione tra il registratore Nox T3s e l'ossimetro non sta procedendo come previsto. Per risolvere il problema, provare quanto segue:

- c) Riavviare l'ossimetro togliendo e rimettendo le sue batterie. Tenere premuto quindi il pulsante di attivazione grigio per accendere l'ossimetro.
- d) Riavviare il registratore Nox T3s estraendo e reinserendo la batteria.



Nota: se l'operazione non è sufficiente e il problema torna a ripetersi con frequenza, potrebbe essere necessario inviare l'T3s o l'ossimetro a un centro di assistenza per la riparazione.

Per ulteriori informazioni per la risoluzione dei problemi, consultare il sito di supporto di Nox Medical.

Manutenzione

La manutenzione del sistema Nox T3s può essere effettuata unicamente da professionisti (operatori sanitari e personale di servizio) dotati delle necessarie competenze e qualifiche.

Conservare il registratore Nox T3s e i suoi accessori in un luogo pulito e asciutto.

Maneggiare il registratore Nox T3s con cura e proteggerlo da urti meccanici, sporco e liquidi. Il dispositivo non è impermeabile o a prova di schizzi.

Per aggiornare il registratore Nox T3s, è necessario che il software Noxturnal (versione 6.0 o successiva) sia in esecuzione sul computer al quale è collegato il registratore. Per maggiori informazioni su questa operazione, fare riferimento al manuale del software Noxturnal.

Non è necessario sottoporre il registratore Nox T3s o i suoi accessori, compresi i cavi paziente, a test periodici.

La vita utile del registratore Nox T3 e della sua borsa da trasporto è pari a 5 anni o 1000 studi, calcolando una media di 200 studi in un anno.

La vita utile del cavo addominale Nox è di 1 anno.

La vita utile dei cavi a scatto degli elettrodi Nox e dei cavi a scatto degli elettrodi Nox bipolari è di 1 anno.

Questa vita utile dipende dal totale rispetto delle istruzioni per l'uso fornite in questo manuale.



- ▶ Avvertenza: rimuovere le batterie dal registratore Nox T3s se non si intende utilizzarlo per più di 30 giorni al fine di prevenire possibili danni dovuti a perdite delle batterie e il rischio di lievi ustioni ai danni dell'operatore o del paziente.
- ▶ Avvertenza: il registratore Nox T3s non contiene parti la cui manutenzione o riparazione possa essere effettuata dall'utente. La manutenzione o riparazione del dispositivo può essere effettuata solo dal personale autorizzato. Eventuali operazioni di manutenzione o riparazione effettuate da personale non autorizzato possono compromettere l'accuratezza dell'analisi dei dati e pertanto l'integrità del trattamento. La garanzia decade se il registratore Nox T3s viene aperto (ad eccezione del vano batteria).
- ▶ Avvertenza: non è consentito di modificare il registratore Nox T3s o i relativi accessori. Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere il buon funzionamento del dispositivo e causare gravi lesioni al paziente.
- ▶ Nota: non è mai consigliabile eseguire il downgrade del firmware del registratore Nox T3s. Il downgrade del firmware comporta la perdita di calibratura del dispositivo. I valori di calibratura verranno sostituiti con valori predefiniti che potrebbero influire sui segnali registrati di pressione e impedenza. Aggiornare il firmware del registratore Nox T3s unicamente con file che provengono direttamente da Nox Medical.

Condizioni ambientali

Temperatura

Esercizio: da +5 °C a +40 °C

Trasporto/Stoccaggio: da -25°C a +70°C

Umidità relativa	Esercizio: 15-90% (senza condensa) Trasporto/Stoccaggio: 10-95% (senza condensa)
Pressione	Resiste alle pressioni atmosferiche tra 700 hPa e 1060 hPa

Calibratura

Il registratore Nox T3s è calibrato in fabbrica. Non sono necessarie ulteriori calibrature.

Pulizia del Nox T3s e dei suoi accessori



- ▶ Avvertenza: Non sterilizzare in autoclave o immergere il registratore Nox T3s o gli accessori in liquidi di qualsiasi tipo. L'ingresso di liquidi comporta il rischio di scosse elettriche.
- ▶ Nota: pulire il registratore Nox T3s separatamente dai relativi sensori.
- ▶ Nota: i componenti del registratore Nox T3s NON devono essere sterilizzati.
- ▶ Nota: il riutilizzo di prodotti monouso su più di un paziente può causare rischi di infezione crociata.
- ▶ Nota: per la pulizia/disinfezione e il riutilizzo di componenti e sensori di terze parti, consultare la relativa documentazione allegata.
- ▶ Nota: la pulizia errata dei componenti riutilizzabili del sistema Nox T3s può provocare contaminazione e/o rischi biologici per il paziente o il medico.
- ▶ Nota: salviette/panni sporchi devono essere smaltiti come materiale a rischio biologico in conformità con le normative federali, statali e locali.

Tutti i componenti riutilizzabili devono essere puliti immediatamente dopo l'uso per prevenire l'accumulo di residui e ridurre al minimo il trasferimento di sporco tra i pazienti.

Istruzioni per la pulizia del sistema Nox T3s

MATERIALI/ATTREZZATURE:

- Endozime® AW Plus
- Panni che non lasciano pelucchi
- Guanti
- Spazzola in nylon a setole morbide (es. spazzola per elettrodi, spazzolino da denti o spazzola per unghie)
- Panno monouso germicida PDI Sani-Cloth Plus o disinfettante equivalente omologato*

PROCEDURA DI PULIZIA/DISINFEZIONE:

1. Preparare una soluzione con il detergente per uso ospedaliero Endozime® AW Plus
 - Attenersi alle istruzioni che accompagnano il detergente per uso ospedaliero.
2. Inumidire con la soluzione un panno che non lascia pelucchi.
 - Non versare o spruzzare liquidi sul registratore Nox T3s.
 - Non lasciare che liquidi penetrino nelle aperture del registratore Nox T3s.
 - Non immergere i cavi in alcun liquido.
 - Evitare il contatto della soluzione detergente con i connettori dei cavi o degli elettrodi.

3. Strofinare accuratamente tutte le superfici per rimuovere sporco e contaminanti visibili. Strofinare il componente per almeno due minuti. Utilizzare una spazzola di nylon a setole morbide se necessario.
4. Esaminare visivamente i componenti puliti per assicurarsi che non vi siano residui di sporco. Prestare particolare attenzione a giunzioni e fessure. Ripetere i passaggi 2 e 3 se necessario.
5. Lasciar asciugare i componenti completamente per almeno tre minuti prima della disinfezione.
6. Per la disinfezione, utilizzare un nuovo panno monouso germicida PDI Sani-Cloth Plus o disinfettante equivalente omologato*.
7. Strofinare tutte le superfici del componente con il disinfettante per almeno tre minuti.
 - Se si utilizzano prodotti per la disinfezione diversi dal panno monouso germicida PDI Sani-Cloth Plus:
 - accertarsi che siano idonei all'uso su metalli e materie plastiche
 - attenersi alle istruzioni del produttore per quanto riguarda il tempo di contatto richiesto della soluzione al fine di assicurare una disinfezione sufficiente
8. Lasciar asciugare i componenti completamente per almeno un minuto prima dell'uso successivo.
9. Esaminare visivamente i componenti in condizioni di luce adeguate (usare una lente di ingrandimento se necessario) per confermare che la procedura di pulizia/disinfezione non abbia danneggiato i componenti. Accertarsi che non vi siano segni di usura superficiale, scolorimento, corrosione o crepe. **

Se necessario, le clip sul registratore Nox T3s possono essere rimosse prima della pulizia. La procedura di pulizia sopra descritta vale anche per le clip. Se le clip sono visibilmente contaminate, le si dovrà sostituire.

* Il panno monouso germicida PDI Sani-Cloth Plus è un prodotto registrato presso l'agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) per la disinfezione dei dispositivi medici negli Stati Uniti d'America. Per l'Europa e il resto del mondo si possono utilizzare disinfettanti omologati equivalenti purché siano idonei all'uso su superfici placcate in oro, metalli e materie plastiche. Salviette disinfettanti simili di PDI sono disponibili in Europa e se ne consiglia l'uso con il sistema Nox T3s: Salviette disinfettanti Super Sani-Cloth Plus, Sani-Cloth AF Universal - Salviette disinfettanti prive di alcool e salviette detergenti e disinfettanti Super Sani-Cloth PDI.

** Se si verificano danni ai componenti durante la procedura di pulizia, contattare immediatamente Nox Medical all'indirizzo support@noxmedical.com. Non tentare di utilizzare il sistema Nox T3s fino a quando il dispositivo non è stato esaminato e riparato dal personale autorizzato di Nox Medical.

Le cinture RIP Nox monouso sono utilizzabili su un SOLO paziente.

Le cannule nasali Nox e i connettori del tubo filtro sono utilizzabili su un SOLO paziente.

Smaltimento

Attenersi alle normative locali e alle istruzioni di riciclo per lo smaltimento di questo dispositivo e dei suoi accessori, incluse le batterie.



- ▶ Nota: in conformità alla Direttiva europea relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/EU, l'apparecchiatura e i suoi componenti non possono essere smaltiti come rifiuti indifferenziati. Per un

corretto trattamento, recupero e riciclaggio, smaltire il prodotto presso un centro di riciclaggio municipale designato dove sarà preso in consegna gratuitamente.

Lo smaltimento corretto del prodotto consente di risparmiare risorse preziose e scongiurare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero altrimenti derivare da un trattamento improprio dei rifiuti.

- ▶ Nota: contattare il proprio distributore sulle modalità di restituzione o riciclo dei componenti.

Dispositivi e sensori compatibili



- ▶ Avvertenza: non è consentito di modificare il registratore Nox T3s o i relativi accessori. Eventuali modifiche non autorizzate possono compromettere il buon funzionamento del dispositivo e causare gravi lesioni al paziente.
- ▶ Per garantire la sicurezza del paziente e l'utilizzo efficiente del sistema Nox T3s, utilizzare solo accessori omologati da Nox Medical.

La tabella seguente contiene informazioni su accessori, sensori e dispositivi omologati per il registratore Nox T3s.

Gli articoli elencati di seguito sono prodotti Nox omologati per l'utilizzo con il registratore Nox T3s:

CINTURE RIP NOX MONOUSO

Tipo	Numero di catalogo
Cinture RIP Nox monouso, 14 set, extra grandi	551050
Cinture RIP Nox usa e getta, 20 set, grandi	551040
Cinture RIP Nox usa e getta, 20 set, medie	551030
Cinture RIP Nox usa e getta, 20 set, piccole	551020
Cinture RIP Nox usa e getta, 20 set, pediatriche	551010

CANNULE NASALI NOX/CONNETTORI DEL TUBO FILTRO

Tipo	Numero di catalogo
Cannula Nox con filtro, 40 unità	552010
Connettore del tubo filtro Nox, 50 unità	552110
Cannula con Luer-lock, pediatrica, 25 unità	552151

COMPONENTI DEL SISTEMA NOX T3S

Tipo	Numero di catalogo
Cavo addominale Nox, s	561212
Borsa di trasporto Nox T3s	568012
Kit di servizio Nox, s	569015
Coperchio vano batteria Nox, s	569020, 569022
Fascetta graffettata (clip strap) Nox, s	569021
Chiave per coperchio vano batteria Nox	569014
Noxturnal	N/A
Noxturnal CD	539010

CAVI A SCATTO ELETTRODI NOX BIPOLARI

Tipo	Numero di catalogo
Cavo doppio a scatto Nox 50/100 cm, arancione, connettore keyhole, 1 unità	554310
Cavo doppio a scatto Nox 30/50 cm, beige-arancione, connettore keyhole, 1 unità	554311
Cavo doppio a scatto Nox 148/150 cm, grigio, connettore keyhole, 1 unità	554312
Cavo doppio a scatto Nox 98/100 cm, beige-grigio, connettore keyhole, 1 unità	554313
Cavo doppio a scatto Nox 148/150 cm, nero, connettore keyhole, 1 unità	554314
Cavo doppio a scatto Nox 98/100 cm, beige-nero, connettore keyhole, 1 unità	554315
Cavo doppio a scatto Nox 50/52 cm, bianco, connettore keyhole, 1 unità	554316
Cavo doppio a scatto Nox 30/32 cm, beige-bianco, connettore keyhole, 1 unità	554317

CAVI A SCATTO ELETTRODI NOX

Tipo	Numero di catalogo
Cavo a scatto Nox 100 cm, verde, 1 unità	554022
Cavo a scatto Nox 50 cm, beige – verde, 1 unità	554023

Gli articoli elencati di seguito sono prodotti di terze parti omologati per l'utilizzo con il registratore Nox T3s:

CAVI ED ELETTRODI

Tipo	Numero di catalogo
Elettrodo a scatto Blue Sensor®, 50 unità	554210
Elettrodo a scatto usa e getta, piccolo, 25 unità	554209

PULSOSSIMETRI

Tipo	Numero di catalogo
Pulsossimetro Nonin WristOx ₂ , modello 3150 BLE	541012

ACCESSORI PER PULSOSSIMETRO

Tipo	Numero di catalogo
Sensore morbido per NONIN WristOx ₂ – Piccolo	553010
Sensore morbido per NONIN WristOx ₂ – Medio	553020
Sensore morbido per NONIN WristOx ₂ – Grande	553030
Cavo sensore NONIN WristOx ₂ Flex con 25 Flexi Wrap, 30 cm – Adulti	553130
Braccialetto NONIN WristOx ₂	564042
Braccialetto WristOx ₂ , monouso	564050

TUBO DI PRESSIONE DELLA MASCHERA

Tipo	Numero di catalogo
Tubo maschera 183 cm femmina x maschio, 50 unità	552320

CAVO USB

Tipo	Numero di catalogo
Cavo USB tipo C	562016

PULIZIA

Tipo	Numero di catalogo
Panno germicida monouso PDI Sani-Cloth Plus	559012
Sani-Cloth AF Universal - Salviette disinfettanti prive di alcool PDI	559011
Endozime® AW Plus	N/A

Specifiche

Nox T3s e accessori

DESCRIZIONE	PROPRIETÀ
<u>FUNZIONE</u>	
Capacità di memoria Nox T3s	▶ 4 GByte
Tempo di registrazione Nox T3s	▶ > 24 ore con batteria nuova al litio
Canali interni Nox T3s	▶ Due canali di sforzo respiratorio delle cinture RIP ▶ Pressione ▶ Rumore respiratorio/russamento ▶ Due canali bipolari (EXG) ▶ Posizione ▶ Attività ▶ Luce
Canali esterni Nox T3s	▶ Dati ossimetrici tramite Bluetooth®
<u>CARATTERISTICHE FISICHE</u>	
Dimensioni dispositivo Nox T3s	▶ 68 mm (L) x 62 mm (A) x 26 mm (P) ± 3 mm
Peso Nox T3s	▶ 70 g ± 3 g senza batteria
Ingressi bipolari Nox T3s	▶ Connettore keyhole touch-proof 1 mm ▶ Gamma d'ingresso ±1024 mV ▶ Larghezza di banda: 0-80 Hz (6 dB) ▶ Frequenza di campionamento: 200 Hz
Sensore di pressione Nox T3s	▶ Campo di pressione in ingresso: -5 cmH ₂ O - +50 cmH ₂ O ▶ Larghezza di banda: 0-90 Hz (6 dB) ▶ Frequenza di campionamento: 200 Hz ▶ Adattatore connettore con Cannula Nox o Connettore del tubo filtro Nox
Lunghezza cavo addominale Nox	▶ 50 cm

- Cavo USB C**
 - ▶ Tipo di connettore USB per il collegamento all'estremità del dispositivo: tipo C
 - ▶ Tipo di connettore USB all'estremità del PC: standard A
- Connettore del tubo filtro Nox**
 - ▶ Filtro idrofobico con entrata Luer Lock femmina – diametro 13 mm, con una capacità di filtraggio di 0,45 µm

ALIMENTAZIONE

- Fonte di alimentazione Nox T3s**
 - ▶ Una batteria AA
 - ▶ PC host (configurazione e download dati)
- Tipo batteria Nox T3s**
 - ▶ Alcalino
 - ▶ Litio
 - ▶ Batteria ricaricabile al nichel-metallo idruro (NiMH)

DISPLAY Nox T3s

- Tipo**
 - ▶ OLED
- Dimensioni display**
 - ▶ 19.5 mm x 37 mm
- Risoluzione**
 - ▶ 128 punti x 64 punti

TRASMETTITORE Nox T3s

- Conformità Bluetooth**
 - ▶ Versione 5.0
- Frequenza di funzionamento**
 - ▶ 2,402-2,480 GHz
- Potenza di uscita**
 - ▶ ≤ 4 dBm
- Topologia della rete**
 - ▶ Da punto a punto: da punto a multipunto
- Funzionamento**
 - ▶ Master Scatter-Net
- Tipo d'antenna**
 - ▶ Interna
- Tipo di modulazione**
 - ▶ Tasti di cambio di frequenza/espansione di spettro mediante il salto di frequenza
- Ampiezza di banda**
 - ▶ 2 Mbps

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO Nox T3s

- RIP torace e addome**
 - ▶ 200 Hz
- Microfono**
 - ▶ 8 kHz
- Ossimetro - Plet**
 - ▶ 75 Hz

AMPIEZZA DI BANDA

- Microfono** ▶ Ampiezza di banda interna da 3,5 kHz

Informazioni sui materiali

COMPONENTE	CONTENUTO MATERIALE
Registratore Nox T3s	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Protezione: acrilonitrile butadiene stirene (ABS)/policarbonato (PC) ▶ Schermo: policarbonato (PC) ▶ Proxy: ABS/PC ▶ Elettrodi a scatto: acciaio inossidabile placcato in oro ▶ Clip: TPU/TPE e acciaio nichelato
Cavo addominale Nox	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Filo del cavo: Tinsel ▶ Guaina cavo: PVC ▶ Protezioni in plastica per addome e torace: PC/ABS ▶ Elettrodi a scatto: acciaio inossidabile placcato in oro ▶ Serracavo per estremità dispositivo: TPE ▶ Serracavo per estremità cintura: PVC ▶ Molle di contatto per estremità dispositivo: acciaio per molle
Cavi elettrodi a scatto Nox, bipolari	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Guaina cavo: PVC ▶ Filo del cavo: Tinsel ▶ Connettore: contatti attacco a molla placcati oro, Riteflex® ▶ Elettrodi a scatto: attacco in ottone placcato nichel, Riteflex®
Cavi elettrodi a scatto Nox, unipolari	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Guaina cavo: PVC ▶ Filo del cavo: Tinsel ▶ Connettore: contatti attacco a molla placcati oro, Riteflex® ▶ Elettrodi a scatto: attacco in ottone placcato nichel, Riteflex®
Borsa di trasporto Nox T3s	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Parte esterna: POLIESTERE BLK 600D ▶ Parte interna: PU ▶ Inserto: ABS
Cinture RIP Nox monouso	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Elastico della cintura: Poliestere/Dorlastan ▶ Connettore: ABS ▶ Filo della cintura: rame stagnato

Informazioni normative

Test delle prestazioni e riepilogo della convalida

Il sistema Nox T3s è stato testato e verificato nelle varie fasi con test interno, verifica e convalida e test esterno per garantire la sicurezza, l'efficacia e l'affidabilità del prodotto. Il progetto è stato verificato e convalidato con valutazione clinica, durante la fase di elaborazione, in base ai requisiti specifici per la sua destinazione d'uso. Ci siamo rivolti a uno studio accreditato esterno per condurre i test di verifica degli conformità agli standard applicabili in materia di compatibilità elettromagnetica (CEM) e sicurezza del paziente, nonché i test aggiuntivi dell'radiofrequenza (RF) per garantire la conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (RED).

La conformità del sistema Nox T3s alle norme in materia di sicurezza dei pazienti e dei dispositivi medici è stata verificata e omologata SOLO con i sensori e gli accessori elencati in questo manuale. Questo vale anche per tutte le caratteristiche del segnale e le funzioni di analisi automatica assicurate dal sistema Nox T3s.

L'uso di sensori o accessori diversi invalida la dichiarazione di conformità emessa da Nox Medical per quanto riguarda i requisiti della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE (MDD). L'uso di componenti diversi da quelli verificati, omologati o raccomandati da Nox Medical è considerato una modifica del sistema Nox T3s. Tali modifiche possono compromettere il buon funzionamento del dispositivo e causare gravi lesioni al paziente.

Il sistema di gestione della qualità certificato ISO 13485:2016 (MDSAP) di Nox Medical è conforme ai requisiti della direttiva sui dispositivi medici (MDD - Direttiva del Consiglio 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE); ai requisiti dei dispositivi medici canadesi - Parte 1 - SOR 98/282; al regolamento australiano sui prodotti terapeutici (dispositivi medici) 2002, Allegato 3, parte 1 (esclusa la parte 1.6) - procedura di garanzia qualità completa; all'ordinanza ministeriale giapponese MHLW MO No 169 (2004), modificata dalla MHLW MO No 60 (2021); e ai regolamenti federali statunitensi 21 CFR 820, 21 CFR 803, 21 CFR 806 e 21 CFR 807 - Capitoli da A a D.

Classificazioni del Nox T3s



- ▶ Grado di protezione (parte applicata) contro le scosse elettriche: l'intero dispositivo è una parte applicata ed è classificato come **tipo BF** (vedere simbolo a sinistra).
- ▶ Alimentazione del dispositivo: il dispositivo è **alimentato internamente**.
- ▶ Grado di protezione contro l'ingresso dannoso di liquidi e polvere:
 - **Il registratore Nox T3s è dotato della classificazione IP22**, vale a dire che – come definito dalla norma CEI 60529 – è protetto da corpi estranei solidi di diametro pari o superiore a 12,5 mm e dalla caduta verticale di gocce d'acqua quando l'involucro è inclinato di non oltre 15°. Il registratore non è protetto dagli spruzzi d'acqua.
- ▶ Metodo di sterilizzazione: il dispositivo **NON viene fornito sterile né è destinato alla sterilizzazione**.
- ▶ Idoneità per l'uso in un ambiente ricco di ossigeno: il dispositivo **NON è destinato all'uso in un ambiente ricco di ossigeno**.
- ▶ Idoneità all'uso con agenti infiammabili e anestetici: il dispositivo **NON è destinato all'uso in combinazione con agenti infiammabili o con miscele anestetiche infiammabili con aria o con ossigeno od ossido di azoto**.

- Modalità di funzionamento: il dispositivo è destinato a un **funzionamento continuo**.

Descrizione dei simboli e delle etichette

	Istruzioni per l'uso/Consultare le istruzioni per l'uso
	Informazioni sul produttore
	Paese e data di produzione
	Non riutilizzare
	Numero di serie
	Codice partita/numero lotto
	Numero di catalogo/numero di riferimento
	Identificativo unico del dispositivo
<p>(01)1569431111XXXX(11)AAMMGG(21)WWWW WWWW</p> <p>(01)1569431111XXXX(11)AAMMGG(10)ZZZZZ</p>	<p>Identificatore univoco del dispositivo (Unique Device Identifier, UDI): l'identificatore dell'applicazione (01) indica l'identificatore del dispositivo (DI) ("1569431111XXXX"), l'identificatore dell'applicazione (11) indica la data di fabbricazione/produzione ("AAMMGG", dove "AA" sono le ultime due cifre dell'anno di produzione, "MM" il mese di produzione e "GG" il giorno di produzione), l'identificatore dell'applicazione (21) indica il numero di serie del dispositivo ove pertinente ("WWWWWWWWW") e l'identificatore dell'applicazione (10) indica il numero di lotto del dispositivo ("ZZZZZ") ove pertinente.</p>
	L'identificatore univoco del dispositivo è presentato in formato matrice dati.
	RFID contenente informazioni sull'identificatore univoco del dispositivo



Parte applicata di tipo BF (protezione del paziente da scariche elettriche)



Conforme alla Direttiva europea relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/EU, l'apparecchiatura e i suoi componenti non possono essere smaltiti come rifiuti indifferenziati. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, smaltire il prodotto presso un centro di riciclaggio municipale designato dove sarà preso in consegna gratuitamente.

Lo smaltimento corretto del prodotto consente di risparmiare risorse preziose e scongiurare effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero altrimenti derivare da un trattamento improprio dei rifiuti.



Radiazione non ionizzante. L'attrezzatura include il trasmettitore RF: è possibile che si verifichino interferenze in prossimità dell'attrezzatura contrassegnata con questo simbolo

CE2797, CE

Marchio CE indicante la conformità ai regolamenti/direttive UE applicabili

Nox T3s

Nome marca/nome modello

ASDB1SEU, ASDB1SKR

Denominazione tecnica

Contiene IC: 25077-NOXBLEMOD

Etichetta Industry Canada (IC)




Tecnologia wireless Bluetooth



Limite di temperatura



Limitazione di umidità



Limitazione di pressione atmosferica



Mantenere asciutto



Fragile, maneggiare con cura

IPN₁N₂

Grado di protezione contro l'ingresso dannoso di acqua e polvere come definito dalla norma CEI 60529, dove N₁ definisce il grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei e N₂ il grado di protezione contro l'ingresso d'acqua



Non idoneo all'uso in un ambiente nel quale vengano effettuate risonanze magnetiche (RM).



Dispositivo medico



Marchio di certificazione della Korea Communications Commission

Tecnologia wireless Bluetooth®

Il registratore Nox T3s si avvale della tecnologia wireless Bluetooth® 5.0 per ricevere segnali esterni da moduli Bluetooth.

La tecnologia wireless Bluetooth si basa su un collegamento radio in grado di offrire una trasmissione affidabile e veloce dei dati. Il collegamento radio Bluetooth utilizza una gamma di frequenza disponibile a livello globale nella banda riservata alle applicazioni di radiocomunicazioni per uso industriale, scientifico e medico (ISM), allo scopo di assicurare la compatibilità della comunicazione su scala mondiale e una veloce acquisizione con schema di modulazione del tipo a salto di frequenza per mantenere la qualità del collegamento anche in ambienti radio rumorosi. Fare riferimento alla sezione “Specifiche” per i dettagli sulle specifiche di radiofrequenza (RF) per il registratore Nox T3s.

Il marchio e il logo *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Nox Medical è regolato da un contratto di licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)



- ▶ Attenzione: esposizione alla radiazione da radiofrequenza.
- ▶ La comunicazione in radiofrequenza (RF) tramite dispositivi portatili e mobili può compromettere le prestazioni del registratore Nox T3s.
- ▶ Avvertenza: le apparecchiature di comunicazione RF portatili (comprese periferiche come cavi di antenne e antenne esterne) vanno utilizzate a una distanza minima di 30 cm da qualsiasi parte del sistema Nox T3s, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, si potrebbe verificare un degrado delle prestazioni di questa apparecchiatura.

- ▶ Avvertenza: il registratore Nox T3s può rilevare interferenze elettromagnetiche (IEM), causando la visualizzazione di segnali disturbati o alterati nel software Noxturnal. Questo può incidere sull'analisi dei dati e comportare un'interpretazione errata dei dati.
- ▶ Avvertenza: i registratori Nox T3s non devono essere utilizzati nei pressi di altre apparecchiature o impilati su di esse. Qualora sia necessario utilizzare i registratori in prossimità di altre apparecchiature o impilarli su di esse, verificare che operino correttamente nella configurazione in cui si intende impiegarli e prevenire anomalie del loro funzionamento tali da poter causare lesioni all'operatore e/o al paziente.
- ▶ Avvertenza: l'uso di accessori, trasduttori, sensori e cavi diversi da quelli elencati in questo manuale può comportare un aumento delle emissioni e/o una riduzione dell'immunità del registratore Nox T3s e causare lesioni all'operatore e/o al paziente.
- ▶ Avvertenza: Il sistema Nox T3s è suscettibile di interferenza da parte di altre apparecchiature, anche qualora esse siano conformi ai requisiti di emissione del comitato internazionale speciale per le interferenze radio (CISPR). Questo può comportare il rischio di lesioni al paziente.
- ▶ Per informazioni specifiche, consultare le tabelle qui sotto relative alla conformità del registratore Nox T3s con la norma CEI 60601-1-2: Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-2: Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali - Norma collaterale: Disturbi elettromagnetici - Requisiti e test.

Dichiarazioni di conformità alle normative di Industry Canada (IC)



Attenzione: qualsiasi cambiamento o modifica all'apparecchiatura non espressamente autorizzato da Nox Medical può annullare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) questo dispositivo non deve emettere interferenze dannose, e
- (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare azioni non desiderate.

Questo dispositivo e le sue antenne non devono essere utilizzati in prossimità di altri trasmettitori se non nel rispetto delle procedure dei prodotti multi-trasmettitore IC.

Dichiarazione IC sull'esposizione alle radiazioni:

Questo dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza per l'esposizione alla radiofrequenza conformità con la norma RSS-102 Numero 5 per l'uso portatile.

Conformità alla norma CEI 60601-1-2: Apparecchiature elettromedicali - Parte 1-2:
 Prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali -
 Norma collaterale: Disturbi elettromagnetici - Requisiti e test.

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Il registratore Nox T3s è concepito per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico come quello indicato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve garantire l'utilizzo in tale ambiente.		
Test emissioni	Conformità	Ambiente elettromagnetico – guida
Emissioni RF CISPR 11	Gruppo 1	Per svolgere le sue funzioni il dispositivo deve emettere energia elettromagnetica. Eventuali attrezzature elettroniche nelle vicinanze potrebbero essere compromesse.
Emissioni RF CISPR 11	Classe B	Il dispositivo può essere utilizzato in tutti gli ambienti, inclusi quelli residenziali e gli ambienti collegati direttamente alla rete elettrica pubblica a bassa tensione che alimenta gli edifici adibiti ad uso residenziale.
Emissioni armoniche CEI 61000-3-2	Non pertinente	
Fluttuazioni elettriche/emissioni flicker CEI 61000-3-3	Non pertinente	

IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA

Il registratore Nox T3s è concepito per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico come quello indicato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve garantire l'utilizzo in tale ambiente.

Test d'immunità	Livello del test CEI 60601	Livello di conformità
Scariche elettrostatiche (ESD) CEI 61000-4-2	±8 kV contatto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV e ±15 kV aria	±8 kV contatto ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV e ±15 kV aria
Fast transient/burst elettrico CEI 61000-4-4	± 2 kV per le linee d'alimentazione di rete ±1 kV per presa parti di ingresso/uscita Frequenza di ripetizione 100 kHz	Non pertinente
Sovratensioni CEI 61000-4-5	±0,5 kV, ± 1 kV da linea a linea ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV da linea a terra	Non pertinente
Cadute di tensione CEI 61000-4-11	0 % U_T per 0,5 cicli a 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° e 315°. 0 % U_T per 1 ciclo 70 % U_T per 25/30 cicli	Non pertinente
Interruzioni di tensione CEI 61000-4-11	0 % U_T per 250/300 cicli	Non pertinente
Campo magnetico frequenza della potenza nominale CEI 61000-4-8	30 A/m 50 o 60 Hz	30 A/m 60 Hz
Disturbi condotti indotti da campi RF CEI 61000-4-6	3 V da 0,15 MHz a 80 MHz 6 V nelle bande ISM e nelle bande radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz 80% AM a 1 kHz	3 V da 0,15 MHz a 80 MHz 6 V nelle bande ISM e nelle bande radioamatoriali tra 0,15 MHz e 80 MHz 80% AM a 1 kHz
Campi EM RF radiati CEI 61000-4-3	10 V/m Da 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz	10 V/m Da 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campi di prossimità da apparecchiature di comunicazione wireless in radiofrequenza CEI 61000-4-3	Fare riferimento a Immunità ai campi di prossimità da apparecchiature di comunicazione wireless in radiofrequenza	Fare riferimento a Immunità ai campi di prossimità da apparecchiature di comunicazione wireless in radiofrequenza

NOTA U_T è la tensione di rete CA prima dell'applicazione del livello di test.

IMMUNITÀ AI CAMPI DI PROSSIMITÀ DA APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE WIRELESS IN RADIOFREQUENZA

Il registratore Nox T3s è concepito per essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico come quello indicato di seguito. Il cliente o l'utente del dispositivo deve garantire l'utilizzo in tale ambiente.

Frequenza di prova (MHz)	Banda (MHz)	Servizio	Modulazione	Potenza massima (W)	Distanza (m)	Livello test di immunità (V/m)	Conformità (Si/No)
385	380-390	TETRA 400	Modulazione di impulsi 18 Hz	1,8	0,3	27	Si
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM Deviazione ± 5 kHz Seno 1 kHz	2	0,3	28	Si
710	704-787	Banda LTE 13, 17	Modulazione di impulsi 217 Hz	0,2	0,3	9	Si
745							
780							
810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, Banda LTE 5	Modulazione di impulsi 18 Hz	2	0,3	28	Si
870							
930							
1720	1700-1990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; Banda LTE 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione di impulsi 217 Hz	2	0,3	28	Si
1845							
1970							
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, Banda LTE 7	Modulazione di impulsi 217 Hz	2	0,3	28	Si
5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Modulazione di impulsi 217 Hz	0,2	0,3	9	Si
5500							
5785							

Informazioni

Il presente manuale e le relative traduzioni sono forniti in formato elettronico, in conformità con il Regolamento della Commissione (UE) n. 207/2012 del 9 marzo 2012 sulle istruzioni elettroniche per l'uso di dispositivi medici. È possibile inoltre reperire la documentazione in formato elettronico presso il sito web di Nox Medical: www.noxmedical.com/ifu.

Le versioni elettroniche sono fornite in formato PDF. Per aprire questi documenti è necessario un lettore PDF. Diversi tipi di lettori PDF sono reperibili gratuitamente e con facilità. Fare riferimento ai requisiti hardware e di sistema pertinenti per il lettore PDF utilizzato.

È possibile richiedere gratuitamente copie cartacee della documentazione inviando una e-mail a support@noxmedical.com. La copia cartacea sarà inviata entro 7 giorni di calendario.